

**ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
- КОНСУМАТИВИ**

Днес, 02.08.2018 г., в гр. Пловдив, се сключи настоящият договор между:

„УМБАЛ – ПЛОВДИВ” АД, ЕИК: 115532049, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „България” №234, представлявано от д-р Иво Петров Мильотев – Изпълнителен директор и Йордан Сталев – главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **„Възложител”**, от една страна

и

„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, ЕИК:103506444, със седалище и адрес на управление: гр. Върна, район Приморски, ул. „Иван Богоров” №12, ет. 2, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев - управител, наричан по-долу за краткост **„Изпълнител”**, от друга страна,

и на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение №ОА-202 от 20.07.2018 г. на Изпълнителния директор на **„УМБАЛ – Пловдив” АД** за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ - КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ” АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”** се сключи настоящият договор за възлагане на **ОП №6 Рентгенови филми и ОП №7 Химикали за авт. Обработка за рентгенови филми**, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на медицински изделия - консумативи по обособена позиция **ОП №6 Рентгенови филми и ОП №7 Химикали за авт. Обработка за рентгенови филми**, съгласно Техническата спецификация – Приложение №1, както и Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) Доставките се извършват периодично, по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които са заявени и които са доставени при условията на настоящия Договор.


II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 (1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора, е в размер до: за **ОП №6 Рентгенови филми** – 24 141,90 лв. (двадесет и четири хиляди сто четиридесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС и **ОП №7 Химикали за авт. Обработка за рентгенови филми** – 3780,60 (три хиляди седемстотин и осемдесет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, обща стойност на договора – 27 922,50 лв. и включва всички плащания към Изпълнителя. Общата прогнозна стойност на доставките е максимална за срока на договора и не е обвързваща за страните, като Възложителят има право, в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялата обща прогнозна стойност.

(2) Единичната цена на доставяните стоки е съгласно Ценово предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката, подписан от представители на страните и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

(2) Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до 60 календарни дни, съгласно разпоредбите на чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, след представяне на фактура за



съответната доставка, считано от датата на издаването на фактурата, придружена с документ удостоверяващ приемането на стоката.

(3) Плащанията се извършват в български лева по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Райфайзенбанк (България) АД; Варна, бул. Осми приморски полк 80 - 82
IBAN BG37RZBB91551064017917
BIC RZBBBGSF

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 2 (два) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(4) Когато Изпълнителят бъде уведомен, че фактура не може да бъде платена поради констатирано несъответствие с условията на този договор, той трябва да отстрани несъответствията в срок от 7 календарни дни след като бъде уведомен. В тези случаи срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на несъответствията.

(5) Паричните вземания по този договор и по договор за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение. В случай, че за парично вземане по този договор и/или по договор за подизпълнение е налице прехвърляне, залагане или принудително изпълнение, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство, като представя надлежно заверено копие от съответните документи.

(6) Когато при изпълнение на Договора участват един или повече подизпълнители, се прилага чл. 15.

III. СРОКОВЕ

Чл. 4 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 12 (дванадесет) месеца.

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл. 5 (1) Мястото на доставка е до: „УМБАЛ – Пловдив” АД - гр. Пловдив, бул. „България” №234. Доставката на медицински изделия - консумативи се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни изисквания.

(2) Изпълнителят се задължава да достави стоките, предмет на настоящия договор не по-късно от три работни дни след получаване на заявка от страна на Възложителя, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 6 (1) При приемане на стоките се подписва двустранен приемно-предавателен протокол, удостоверяващ, че стоките от съответния вид, количество и качество са получени. При всяка доставка се представя сертификат от производителя на медицинските изделия - консумативите удостоверяващ срока им на годност.

(2) За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател, съгласно подписания двустранен приемно-предавателен протокол.

(3) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените медицински изделия - консумативи, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия договор. Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на медицинските изделия и след отстраняване на несъответствията.

(4) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:



а) несъответствия на доставените медицински изделия - консумативи със заявеното количество и/или със заявения вид;

б) несъответствието на доставените медицински изделия - консумативи с Техническото предложение и с Техническата спецификация неразделна част от настоящия договор;

(5) Рекламации за скрити несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им.

(6) При несъответствие на доставените медицински изделия - консумативи с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи, Изпълнителят заменя несъответстващите медицински изделия - консумативи с нови, съответно допълва доставката, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от подписване на съответния протокол от страните.

(7) Когато Изпълнителят е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

Чл. 7 Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на медицинските изделия - консумативи, предмет на доставка, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата (момента) на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8 (1) Изпълнителят се задължава:

а) след изпратена заявка от **Възложителя**, получена на факс на Изпълнителя: (052) 699060 или имейл: elpak@elpak.bg, да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с необходимата документация, както и условията на Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, по единични цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор;

б) да предаде стоките в съответния вид, количество, качество и срок на годност на мястото на доставяне.

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права с оглед защита интересите на Възложителя.

(3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определени видове продукти или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя. При системен отказ на Изпълнителя (три или повече пъти в рамките на срока на договора) да изпълни направената заявка, Възложителят има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.

(4) Изпълнителят е длъжен да приеме и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия договор.

(5) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на плащане.

(6) Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор. С срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора и на допълнителното споразумение на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66 от ЗОП.

(7) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(8) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи, съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя.



(9) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените стоки с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този договор, и е длъжен да обезпечи всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от несъответстващи продукти.

(10) Отговорността за изпълнение на настоящия договор е на Изпълнителя, независимо от възможността за използване на подизпълнител/и. Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставена от него некачествена стока.

(11) Изпълнителят няма право да доставя медицински изделия - консумативи предмет на настоящия договор, различни от посочените в приложенията, и/или произведени от друг производител, освен посочения в техническото предложение.

(12) Изпълнителят има право, при доказана по надлежен ред и със съответни документи обективна невъзможност, възникнала независимо от неговата воля, да доставя един или повече медицински изделия - консумативи в съответствие с посочените в техническото предложение, писмено да предложи на Възложителя същите да бъдат заменени с други еквивалентни стоки, за които представя подходяща документация за доказване съответствието им с изискванията на Възложителя, поставени в документацията на обществената поръчка. Промяната/замяната ще се извършва единствено след изразено писмено съгласие от страна на Възложителя.

(13) В случаите на одобрена промяна/замяна не се допуска увеличаване на единичните цени на доставка и/или на общата стойност на договора.

(14) При изпълнението на настоящия договор Изпълнителят и неговите подизпълнители (когато е приложимо) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9 (1) Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените стоки, съгласно условията и по начина, посочени в настоящия договор.

(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на стоките, предмет на доставка по реда на чл. 5, ако отговарят на договорените изисквания.

(3) Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в договореното време.

(4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставките на стоките до посоченото в чл. 5, ал. 1 от договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите предмет на договора.

(6) Възложителят има право на рекламация на доставените по договора стоки, при условията, посочени в настоящия договор.

(7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи медицински изделия - консумативи с изискванията на Договора.

(8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на договора и техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

(11) При системно неизпълнение (три или повече пъти в рамките на срока на договора) на изискванията на този договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати договора.

(12) Възложителят има право да не заяви в пълен обем дадено прогнозно количество медицински изделия - консумативи, съгласно Техническата спецификация.



VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10 (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произитчащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора по чл. 2, ал. 1 от договора, без ДДС, равняваща се на за ОП №6 Рентгенови филми – 482,84 лв. и ОП №7 Химикали за авт. Обработка за рентгенови филми – 75,61 лв., общо в размер на 558,45 лв.

(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на договора към датата на сключването му.

(3) Гаранцията е представена под формата на банкова гаранция (*парична сума, банкова гаранция или застраховка*).

(4) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Чл. 11 (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

Юробанк България АД

IBAN: BG52BPBI79245084058801

BIC: BPBIBGSF

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

(2) Когато изпълнителят представи банкова гаранция, се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100% (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.

(3) Страните се съгласяват, в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(4) Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(5) Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

(6) При подновяване на Договора съгласно чл. 18, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на представената гаранция или да представи нови гаранция, при условията на настоящия договор.

Чл. 12 (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) дни, след прекратяване на настоящия договор, при условие, че не са налице обстоятелства за нейното задържане.

(2) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми,



покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, страните изрично се споразумяват, че:

а) Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на три месеца) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя медицински изделия - консумативи; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на три месеца) несъответствие на доставените медицински изделия - консумативи с договорените изисквания;

б) При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити несъответствия, установени по предвидения в договора ред и в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени медицински изделия - консумативи, Възложителят има право да задържи/усвои от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на несъответстващите стоки, чиято доставка е отказана;

в) Възложителят има право да задържа/усвоява от сумите по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(4) В случай на задържане/усвояване от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителя е длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 10, ал. 1, като внесе задържаната/усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната/усвоената, или да застрахова отговорността си до размера в чл. 10, ал. 1.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 13 (1) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 3% (три на сто) от стойността на консумативите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 50% (петдесет на сто) от стойността на консумативите, за която се отнася забавата.

(2) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатираните несъответствия, продължила повече от 5 дни, Възложителят има право да прекрати настоящия договор, като даде на Изпълнителя 5 дневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка, равна на 5% (пет на сто) от разликата между прогнозната стойност на договора по чл. 2, ал. 1 и цената на извършените доставки в изпълнение на договора.

(3) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на срока на договора, чиято основателност е установена по предвидени в Договора ред, Възложителят има право да прекрати договора едностранно, както и на неустойка, равна на 5% (пет на сто) от разликата между прогнозната стойност на договора по чл. 2, ал. 1 и цената на извършените доставки в изпълнение на договора.

(4) При прекратяване на настоящия договор от Възложителя на някое от основанията по чл. 17, ал. 2, букви „а“, „б“ и „в“ Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояване на гаранцията за изпълнение.

(6) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по посочена от последния банкова сметка. В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи/усвои съответната сума от гаранцията за изпълнение.

(7) В случай, че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без основание, той дължи на Изпълнителя неустойка, равна на 1% (едно на сто) от разликата между прогнозната стойност на договора и цената на извършените до момента на прекратяване доставки.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ



Чл. 14 (1) За извършване на дейностите по договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител – *Изпълнителят не е декларирал ползването на подизпълнители при изпълнение предмета на настоящия договор.*

(2) За извършване на дейностите по договора, Изпълнителят е посочил в офертата си следния/те подизпълнител/и:

Подизпълнител:, ЕИК:, седалище и адрес на управление:, представлявано от

Вид на дейностите, които ще изпълнява:

Дял от поръчката, който ще изпълнява:

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно договора за подизпълнение.

(4) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(5) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия – по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП. При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(6) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на Изпълнителя.

(7) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред, или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 15 При сключване на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

а) приложимите клаузи на договора за задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

б) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

в) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.


Чл. 16 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Искането трябва да съдържа най-малко следната информация: идентификационни данни за подизпълнителя, основание и сума на искането на разплащане, вида на изпълнените дейности като отделен обект/част от поръчката, съответстващия на тези дейности дял от поръчката, банкова сметка, по която да се извърши плащането. Искането трябва да бъде придружено от документи, доказващи го по основание и размер.

(3) Към искането по чл. 16, ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по чл. 16, ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Х. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА



Чл. 17 (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

- а) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- б) с изтичане на уговорения срок или с достигане на общата прогнозна стойност на доставките по чл. 2, ал. 1, което от двете събития настъпи по-рано;
- в) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- г) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора („непреодолима сила“) продължила повече от 15 (петнадесет) дни;
- д) при прекратяване на юридическо лице – страна по договора, без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
- е) при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ, и в други случаи предвидени по закон.

(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:

- а) при системни (три или повече пъти) в рамките на срока на договора: забавяне на доставки на медицински изделия - консумативи; и/или забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия, констатирани по реда на договора; и/или отказ за извършване на доставка; и/или доставка на консумативи с несъответствия с изискванията на договора, констатирани по реда на договора;
- б) в случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител, е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
- в) не отстрани в срока по чл. 6, ал. 6, констатирани при условията на този договор несъответствията на стоките (рекламации);
- г) когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.


(3) Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните.

(4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнението на договора.

Чл. 18 (1) Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

(2) Съгласно условията на документацията за обществената поръчка, се предвижда възможност за подновяване на договора, включващо повторение на доставките за срок от 12 (дванадесет) месеца, със същият обем и същата прогнозна стойност, при следните условия:

- а) настоящият договор може да бъде еднократно подновен, по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ППЗОП, по инициатива на Възложителя, при наличие на финансов ресурс и необходимост от доставки на стоките, предмет на договора;
- б) подновяването може да бъде иницирано от Възложителя при възникване на обстоятелство по чл. 17, ал. 1, буква „б“ от настоящия договор;
- в) подновяването включва повторение на всички дейности по предмета на договора, при същите условия, за срок от 12 (дванадесет) месеца, същият обем и обща стойност от условията по настоящия договор;
- г) в случаите на подновяване, максималната обща стойност по чл. 2, ал. 1, с включено подновяване, не може да надвишава за ОП №6 Рентгенови филми – 48 283,80 лв. (четиридесет и осем хиляди двеста осемдесет и три лева и осемдесет стотинки) без ДДС и ОП №7 Химикали за авт. Обработка за рентгенови филми – 7 561,20 лв. (седем хиляди петстотин шестдесет и един лева



и двадесет стотинки) без ДДС лв. без ДДС, а максималният срок по чл. 4 с включено подновяване, е 24 месеца.

д) подновяването се осъществява единствено при отправено възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, в което е посочена началната дата на изпълнение. Възлагателното писмо за подновяване става неразделна част от договора.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 19 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността от изпълнение се дължи на непреодолима сила, по смисъла на чл. 306 от ТЗ. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 20 (1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнение на договора: *няма конфиденциална информация.*

(2) Никоя страна няма право без предварително писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21 (1) За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всички промени относно статута си, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, промени в обстоятелствата, изпадане в неплатежоспособност, откриване на производство по несъстоятелност съгласно ТЗ и други. Уведомяването се извършва писмено в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна, като Изпълнителят представя и надлежно заверено копие от съответния/те документ/и.

(3) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в регламентираният със закон случай.

Чл. 22 (1) Упълномощени представители на страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия договор са:

За Възложителя:

Д-р Аргир Аргиров – Прокуриснт на УМБАЛ АД;

Гр. Пловдив, бул. „България“ №234, ет. 15, тел. 032/959221, имейл: mbalplovdiv@abv.bg

За Изпълнителя:


Д-р Венелин Стоянов – търговски представител фирма „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД

Тел: 0887693556, имейл: elpak@elpak.bg

(2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор, следва да съдържа наименованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(4) Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в настоящия договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията, изпратена на адресите по настоящия чл. 22, се считат за валидно изпратени и получени от другата страна.



(5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронна поща на страните.

Чл. 23 (1) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в случай на спор, всяка страна може да изпрати на другата, на посочените адреси за кореспонденция, покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България.

Чл. 24 Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 25 Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение №3 Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящия договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Д-р Иво Мильотев

Изпълнителен директор

Йордан Сталев


Главен счетоводител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Пламен Калайджиев

Управител



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Долуподписаният: инж. Пламен Антонов Калайджиев в качеството ми на : Управител (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40 от ППЗОП), представляващ „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД (посочва се юридическо лице, еднолично търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ - КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**


Ви представям настоящото техническо предложение за **Обособена позиция № 6 Рентгенови филми** във връзка с обявената от Вас процедура:

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложили в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.
2. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор.
3. Декларирам, че срока на валидност на офертата е 4 месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти от Възложителя.
4. Декларирам, че срока на доставка след направена заявка от Възложителя е 3 /три/ работни дни *(срокът предположен от участника не може да е по-дълъг от три работни дни, участник предположил по-дълъг срок за доставка ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка)*.
5. Декларирам, че е нанесена СЕ маркировка върху предложеното/ите медицинско/и изделие/я – консуматив/и, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;
6. Декларирам, че осигуряваме и поддържаме документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ.
7. Декларирам, че остатъчният срок на годност на медицинско/и изделие/я – консуматив/и, които ще бъдат доставяни, ще бъде не по-кратък от 40% към датата на доставката.

При подаване на оферта за номенклатурите по обособена позиция №3, участниците представят за доказване на съответствието на предложеното/ите медицинско/и изделие/я – консуматив/и със Спецификацията на възложителя - проспекти/каталози/спецификации *(посочва се конкретно)* от производителя, както и Техническа спецификация на предлаганото/ните изделие/я – консуматив/и.

Забележка: В приложените документи участникът следва по подходящ начин да обозначава (маркира) конкретната информация, представена за доказване на съответствието на предложеното/ите медицинско/и изделие/я със Спецификацията на възложителя.

8. Заявяваме, че в случай че бъдем избрани за изпълнител на договора на обществената поръчка, ще доставим следното медицинско изделие - консуматив:



№	Наименование и пълно описание на медицинското изделие	Търговско наименование	Производител	Единица мярка	Планирано количество в единица мярка
1	3 Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 13/18 x 100 бр в кутия Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолия с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	4	5	6	7
6.1	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 18/24 x 100 бр в кутия Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолия с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	Mediphot X-O/RP, зеленочувствителни 13/18, кутия 100 филма	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	кутии	8
6.2	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 18/24 x 100 бр в кутия Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолия с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	Mediphot X-O/RP, зеленочувствителни 18/24, кутия 100 филма	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	кутии	60
6.3	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 24/30 x 100 бр в кутия Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолия с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	Mediphot X-O/RP, зеленочувствителни 24/30, кутия 100 филма	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	кутии	60

6.4	дебелина от 0.18 мм. Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 30/40 x 100 бр в кутия Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолія с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	Mediphot X-O/RP, зеленочувствителни 30/40, кутия 100 филма	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	кутии	40
6.5	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 35/35 x 100 бр в кутия Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолія с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	Mediphot X-O/RP, зеленочувствителни 35/35, кутия 100 филма	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	кутии	75
6.6	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 20/40 x 100 бр в кутия Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолія с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	Mediphot X-O/RP, зеленочувствителни 20/40, кутия 100 филма	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	кутии	35
6.7	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 35/43 x 100 бр в кутия Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със	Mediphot X-O/RP, зеленочувствителни 35/43, кутия	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	кутии	50


зелена светлина. Подходящ за фолия с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0,18 мм.	100 филма			
--	-----------	--	--	--

В графа № 3 – Наименование, Участникът описва подробно предлаганото от него медицинско изделие - консуматив.

Когато, изисканата от Възложителя информация, за доказване на съответствието на предлаганото медицинско изделие и посочените такива в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка е публично достъпна, на определен интернет адрес, участникът може да посочи интернет адреса без да прилага данни на хартиен носител.

Дата: 30.05.2018 г

Участник: „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД



Управител:.....
Инж. Пламен Калайджиев


Бургас тел./факс: (056) 803510
Русе тел./факс: (082) 826601

Плевен тел./факс: (064) 800649
София тел./факс: (02) 9532767

Пловдив тел./факс: (032) 675307
Ст. Загора тел./факс: (042) 661158

MEDIPHOT X-O/RP

Зелено-чувствителни рентгенови филми за обща диагностика.

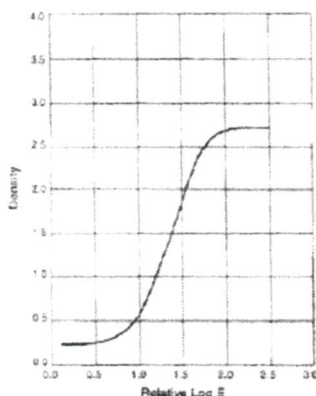

Проявени с MEDIPHOT E90 при
33°C (92 °F), 90 sec.

Зелено-чувствителни – за употреба с излъчващ екран със зелена светлина.

Подходящ за фолия с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800.

Двойно покрита емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване.

Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой.


За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.

Налични в размери за всички стандартни касети. 100 филма в кутия, без индивидуално опаковане.

100 бр. филми в кутия

MEDIPHOT X-90N/RP

Синьо-чувствителни рентгенови филми за обща диагностика

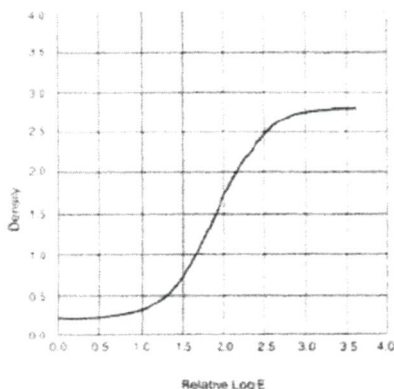

Проявени с MEDIPHOT E90 при
33°C (92 °F), 90 sec.

Синьо-чувствителни – за употреба със синя светлина и УВ излъчващ екран

Подходящ за фолия с редкоземни материали и CaWO_4 като MEDIPHOT K100 – K800 и MEDIPHOT H100 – U200

Двойно покрита емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване

Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филните. С електростатичен защитен слой.


За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.

Налични в размери за всички стандартни касети. 100 филма в кутия, без индивидуално опаковане.

MEDIPHOT X-MA/RP

обработка

Зелено-чувствителни мамографски филми за автоматична

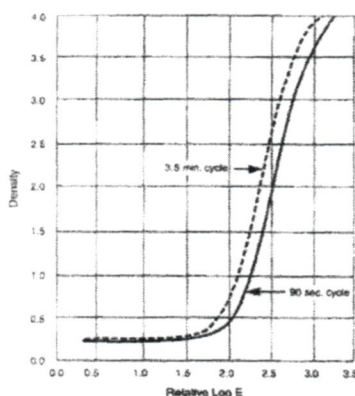

Проявени с MEDIPHOT E90 при
33°C (92 °F), 90 sec.

Зелено-чувствителни – за употреба със зелено излъчващ екран

Подходящи за редкоземни единични екрани като MEDIPHOT MA 50 и MA 100 мамографски екрани.

Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой.

Високосъдържателни, с едностранна емулсия с противоотблясъчен слой, даващ висока резолюция, отличен контраст с минимално замъгляване.

Антистатичен предпазен екран

За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.

Налични в размери за всички стандартни касети. 100 филма в кутия, без индивидуално опаковане.

Набраздени за лесна откриване на емулсивната страна (горна страна) когато маркировката е в горния десен ъгъл.

Налични във всички стандартни размери. 100 филма в кутия без индивидуално опаковане.

ЕЛПАК

МЕДИЦИНСКА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АПАРАТУРА

централен офис: Варна 9002, ул. Иван Водаров 12

тел.: (052) 602360 факс: 699060

Офис Варна:

Варна 9009, бул. Владислав, бл. 54

тел./факс: (052) 730160

Интернет:

www.elpak.com elpak@elpak.bg

Бургас тел./факс: (056) 803510

Плевен тел./факс: (064) 800649

Пловдив тел./факс: (032) 675307

Русе тел./факс: (082) 826601

София тел./факс: (02) 9532767

Ст. Загора тел./факс: (042) 661158

Препоръки за работа с всички филми MEDIPHOT

Проявител

прибл. 32 °C (115 °C)

подмяна

300* мл/м2 – проявител

Темп.


прибл. 29 °C (110 °F)

400* мл/м2 – фиксаж

Съхранение:

макс 23 °C, влажност 30-60 %

ВАРНА
СЪХРАНЕНИЕ




Кец

MEDIPHOT

X-RAY FILMS
Colenta DATASHEET

MEDIPHOT X-O/RP Green-light sensitive x-ray film for General X-Ray Diagnostics

Sensitometry:

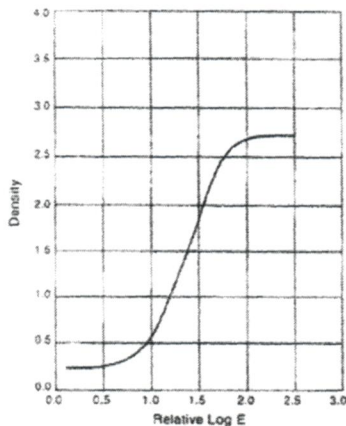

Specifications:

GREEN SENSITIVE - for use with green-light emitting intensifying screens. Suitable for RARE EARTH SCREENS, like MEDIPHOT KO100 - KO800.

Double coated emulsion - EXCELLENT DEFINITION with HIGH CONTRAST and LOW FOG LEVEL.


With electrostatic protection layer. Suitable for serial exposures and rapid film changing systems

For 90 sec RP AUTOMATIC PROCESSING-EXTENDED PROCESSING CYCLES and MANUAL PROCESSING SYSTEMS. BLUE POLYESTER BASE - 0.18 mm thickness. Available in ALL STANDARD cassette SIZES. Boxes of 100 SHEETS NIF (No Inside Folding).

Developed in MEDIPHOT E90 at 33°C (92°F), 90 sec.

MEDIPHOT X-90/RP Blue-light sensitive x-ray film for General X-Ray Diagnostics

Sensitometry:

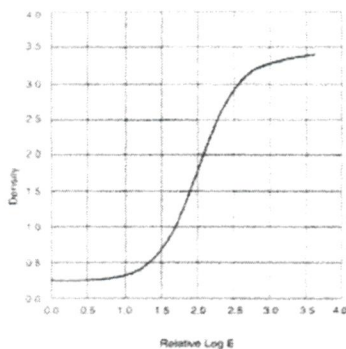

Specifications:

BLUE SENSITIVE - for use with blue-light and UV-emitting intensifying screens.

Suitable for RARE EARTH and CaWO_4 -Screens like MEDIPHOT K100 - K800 and MEDIPHOT H100 - U200.

Double coated emulsion - EXCELLENT DEFINITION with HIGH CONTRAST and LOW FOG LEVEL.

Suitable for serial exposures and rapid film changing systems. With electrostatic protection layer


Developed in MEDIPHOT E90 at 33°C (92°F), 90 sec.

For 90 sec RP AUTOMATIC PROCESSING-EXTENDED PROCESSING CYCLES and MANUAL PROCESSING SYSTEMS. BLUE POLYESTER BASE - 0.18 mm thickness. Available in ALL STANDARD cassette SIZES. Boxes of 100 SHEETS NIF (No Inside Folding).

MEDIPHOT X-90N/RP

Blue-light sensitive x-ray film for General X-Ray Diagnostics

Sensitometry:

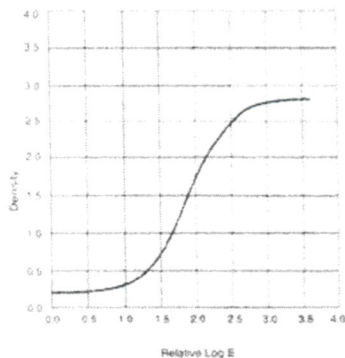

Developed in MEDIPHOT E90 at 33°C (92°F), 90 sec.

Specifications:

BLUE SENSITIVE – for use with blue-light and UV-emitting intensifying screens.

Suitable for RARE EARTH and CaWO_4 -Screens like MEDIPHOT K100 – K800 and MEDIPHOT H100 – U200.

Double coated emulsion – EXCELLENT DEFINITION with HIGH CONTRAST and LOW FOG LEVEL.


Suitable for serial exposures and rapid film changing systems. With electrostatic protection layer

For 90 sec RP AUTOMATIC PROCESSING-EXTENDED PROCESSING CYCLES and MANUAL PROCESSING SYSTEMS. BLUE POLYESTER BASE – 0.18 mm thickness. Available in ALL STANDARD cassette SIZES. Boxes of 100 SHEETS NIF (No Inside Foldinging).

MEDIPHOT X-MA/RP

Green-light sensitive film for Mammography for RP-Processing

Sensitometry:

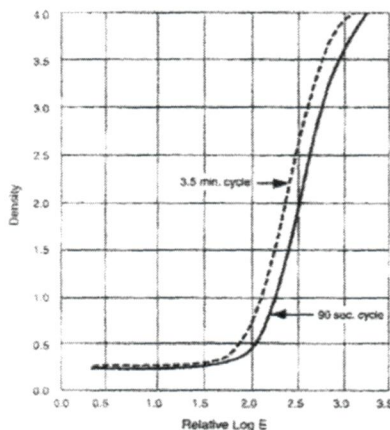

Developed in MEDIPHOT E90 at 33°C (92°F), 90 sec.

Specifications:

GREEN SENSITIVE - for use with green-light emitting intensifying screens.

Suitable for RARE EARTH single back screen, e.g. MEDIPHOT MA 50 AND MA 100 mammography screen.

HIGHLY CONSISTENT, single coated emulsion with ANTIHALO LAYER, giving HIGH RESOLUTION, EXCELLENT CONTRAST with LOW FOG LEVEL.

Includes electrostatic protection layer.

For 90 sec RP AUTOMATIC PROCESSING-EXTENDED PROCESSING CYCLES and MANUAL PROCESSING CYCLES and MANUAL PROCESSING SYSTEMS, BLUE POLYESTER BASE - 0.18 mm thickness.

Notched for easy identification of emulsion side (emulsion side up, when notch in the upper right corner). Available in ALL STANDARD Imagerecording SIZES. Boxes of 100 SHEETS NIF (No Inside Foldinging).

Darkroom Illumination for X-O/RP and X-MA/RP Films:

15 W bulb. lamp / table distance not closer than 1 mt. / Filters- Wratten 1 or GBX2 or equivalent. Colour red.

Processing Recommendations for all MEDIPHOT Films:

Developer approx. 32°C * (115°F) at 90 sec
temp.: approx. 29°C * (110°F) at 180 sec

* For MEDIPHOT PROCESSING CHEMISTRY

Some makes of chemistry may require higher process temperatures and replenishment rates.

Replenishment: 300 * ml/m² for Developer
400 * ml/m² for Fixer

Storage of MEDIPHOT Films: max. 23°C (73,4°F) and at 30 – 60% rel. humidity.


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Долуподписаният: инж. Пламен Антонов Калайджиев в качеството ми на : Управител (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40 от ППЗОП), представляващ „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ - КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Ви представям настоящото техническо предложение за **Обособена позиция № 7 Химикали за авт. обработка за рентгенови филми** във връзка с обявената от Вас процедура:

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложили в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.
 2. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор.
 3. Декларирам, че срока на валидност на офертата е 4 месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти от Възложителя.
 4. Декларирам, че срока на доставка след направена заявка от Възложителя е 3 /три/ работни дни *(срокът предположен от участника не може да е по-дълъг от три работни дни, участник предположи по-дълъг срок за доставка ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка)*.
 5. Декларирам, че е нанесена СЕ маркировка върху предложеното/ите медицинско/и изделие/я – консуматив/и, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;
 6. Декларирам, че осигуряваме и поддържаме документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ.
 7. Декларирам, че остатъчният срок на годност на медицинско/и изделие/я – консуматив/и, които ще бъдат доставяни, ще бъде не по-кратък от 40% към датата на доставката.
- При подаване на оферта за номенклатурите по обособена позиция №3, участниците представят за доказване на съответствието на предложеното/ите медицинско/и изделие/я – консуматив/и със Спецификацията на възложителя - проспекти/каталози/спецификации *(посочва се конкретно)* от производителя, както и Техническа спецификация на предлаганото/ните изделие/я – консуматив/и. Забележка: В приложените документи участникът следва по подходящ начин да обозначи (маркира) конкретната информация, представена за доказване на съответствието на предложеното/ите медицинско/и изделие/я със Спецификацията на възложителя.
8. Заявяваме, че в случай че бъдем избрани за изпълнител на договора на обществената поръчка, ще доставим следното медицинско изделие - консуматив:



№	Наименование и пълно описание на медицинското изделие	Търговско наименование	Производител	Единица мярка	Планирано количество в единица мярка
1	3	4	5	6	7
7.1	Проявител Mediphot E90 Опаковка от 2 туби по 5 литра - концентрат Бързодействащ RP (Rapid Processing) проявител на основата на хидрохинон / фенолон, подходящ за всички видове рентгенови филми, за използване във всички ролкови проявителни машини. Ниска температура на проявяване Ниска консумация Повторяемост на резултатите с минимално замъгляване. Минимално окисляване. Барабанът на проявителната машина остава чист. Подходящ за продължителни програми и ръчно проявяване. Настройка на яркостта чрез промяна на температурата. Наличен за всички видове химически миксери. Препоръчителна температура при определено време за проявяване 37°C-39°C при 60 секунди 34°C-36°C при 90 секунди 33°C-35°C при 120 секунди 31°C-34°C при 150 секунди Препоръчителна скорост на подмяна: 300 мл/м2 за среден/голям обем на проявяване (150 филма дневно) 400 мл/м2 за нисък обем на проявяване 100 (филма дневно)	Mediphot Проявител E90	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	брой	60
7.2	Фиксаж Mediphot F90 Опаковка от 2 туби по 5 литра - концентрат Бързодействащ RP (Rapid Processing) фиксаж на основата на амониев трисулфат., подходящ за всички видове рентгенови филми, за използване във всички ролкови проявителни машини. Спецификация: Високоскоростен фиксаж с широк температурен обхват. Ниска консумация. Ефективно втвърдяване с ниска абсорбция на вода, което спомага за бързо изсушаване. Остава барабана чист с по-малко отлагания. Подходящ за машинно и ръчно проявяване (в случай на ръчно проявяване не се добавя втвърдител). За всички видове за смесители. Минимални емисии на SO2 на готовия работен разтвор. Препоръчителна температура при определено време за проявяване Температурата не трябва да превишава избраната температура на проявителя.	Mediphot Фиксаж F90	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	брой	60



Handwritten signature

Handwritten signature

	Препоръчителна скорост на подмяна 350-400 мл/м2 за среден/голям обем на проявяване (1.00 филма дневно) 450 мл/м2 за нисък обем на проявяване 100 (филма дневно) Концентрация на сребро 8 г/л (прибл) Температура на смесване Не повече от 25 °C						
--	--	--	--	--	--	--	--

В графа № 3 – Наименование, Участникът описва подробно предлаганото от него медицинско изделие - консуматив.

Когато, изисканата от Възложителя информация, за доказване на съответствието на предлаганото медицинско изделие и посочените такива в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка е публично достъпна, на определен интернет адрес, участникът може да посочи интернет адреса без да прилага данни на хартиен носител.

Дата: 30.05.2018 г

Участник: „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД



Управител:.....
Инж. Пламен Калайджиев

(Handwritten signatures and marks)

MEDIPHOT

X-RAY CHEMISTRY
Colenta® DATASHEET

MEDIPHOT E90 (течен концентрат)

Бързодействащ RP (Rapid Processing) проявител на основата на хидрохинон / фенидон, подходящ за всички видове рентгенови филми, за използване във всички ролкови проявителни машини.

Спецификация:

Ниска температура на проявяване

Ниска консумация

Повторяемост на резултатите с минимално замъгляване.

Минимално окисляване. Барабанът на проявителната машина остава чист. Подходящ за продължителни програми и ръчно проявяване. Настройка на яркостта чрез промяна на температурата. Наличен за всички видове химически миксери.

Препоръчителна температура при определено време за проявяване

37°C-39°C при 60 секунди
34°C-36°C при 90 секунди
33°C-35°C при 120 секунди
31°C-34°C при 150 секунди

Препоръчителна скорост на подмяна:

300 мл/м2 за среден/голям обем на проявяване (150 филма дневно)
400 мл/м2 за нисък обем на проявяване
100 (филма дневно)

Стартер MEDIPHOT S

20 мл/л се добавят в резервоара на проявителната машина. към вече готовия работен разтвор
Температура на смесване
Не повече от 25 ° C

MEDIPHOT F90 (течен концентрат)

Бързодействащ RP (Rapid Processing) фиксаж на основата на амониев трисулфат., подходящ за всички видове рентгенови филми, за използване във всички ролкови проявителни машини.

Спецификация:

Високоскоростен фиксаж с широк

температурен обхват.. Ниска консумация.

Ефективно втвърдяване с ниска абсорбция на вода, което спомага за бързо изсушаване.

Остава барабана чист с по-малко отлагания.

Подходящ за машинно и ръчно проявяване (в случай на ръчно проявяване не се добавя втвърдител). За всички видове за смесители.

Минимални емисии на SO₂ на готовия работен разтвор.

Препоръчителна температура при определено време за проявяване

Температурата не трябва да превишава избраната температура на проявителя.

Препоръчителна скорост на подмяна

350-400 мл/м2 за среден/голям обем на проявяване (150 филма дневно)
450 мл/м2 за нисък обем на проявяване
100 (филма дневно)
Концентрация на сребро 8 г/л (прибл)

Температура на смесване

Не повече от 25 ° C

MEDIPHOT E
87% H₂O2



MEDIPHOT E90
(течен концентрат)

Спецификация за готов пресен разтвор
рН: 10.30 при 20 °С (68 °Ф)
специфична гравитация: 1.076 при 20 °С (68 °Ф)

Забележка: Дори малки количества замърсяване с фиксаж, значително ще променят качеството на проявителя. За избягване на окисляване, използвайте плаващ капак в резервоара.

Концентрат за комплект

Part A = 2 x 5,0 л

Part B = 2 x 5,0 л

MEDIPHOT F90
(течен концентрат)

Спецификация за готов пресен разтвор
рН: 4.45 при 20 °С (68 °Ф)
специфична гравитация: 1.091 при 20 °С (68 °Ф)

Бележка: за почистване на резервоарите и ваните използвайте Medihot Cleaning Chemistry

Концентрат за комплект

Part A = 2 x 4.5 л

Part B = 2 x 5,0 л (втвърдител)

Комплект химикали	Вид на химикалите	За готов за използване разтвор	Размер на кутията	Тегло за комплект за кутия
2 x 20 = 40 л	Проявител концентрат	2 x 20 л	36 x 19 x 31 см	15.0 кг
2 x 20 = 40 л	Фиксаж концентрат	2 x 20 л	36 x 19 x 31 см	14.0 кг
Бутилка 0.5 л	Стартер за Проявител E90	20 мл на литър проявител	За 6 бутилки по 0.5 л 23 x 16 x 18 см	3.7 кг

РЕЗЕРВ
ВАРИАНТ

Handwritten signature



Handwritten signature

MEDIPHOT

52491

X-RAY CHEMISTRY
Colenta® DATASHEET

MEDIPHOT E90

(liquid concentrate)

RP (Rapid Processing), hydroquinone/phenidone based developer, suitable for all types of Medical X-Ray Films, to be used in all types of roller transport processors.

Specifications:

Low developer temperature.
Low replenishment rate developer.
Consistent results with low fog values.
Min. air oxidation. Keeps roller of processor clean.
Suitable for extended process-cycles and manual processing. Contrast adjustable by variation of temperature. Available for all types of chemical mixers.

Recommended Temperatures at various processing cycles:

37°C – 39°C at 60 sec
34°C – 36°C at 90 sec
33°C – 35°C at 120 sec
31°C – 34°C at 150 sec

Recommended Replenishment Rates:

300 ml/m² for medium/high volume film processing (150 films up/day)
400 ml/m² for low volume film processing (less than 100 films/day)

Starter MEDIPHOT S:

20 ml/lit. to be added to the ready mixed working solution in processor tank

Mixing Temperature:

tempered water not more than 25°C

Specs for ready mixed, fresh developer working solution:

pH: 10.30 at 20°C (68°F)
Specific Gravity: 1.076 at 20°C (68°F)

NOTE: Even small contaminations by fixer solutions will change the quality of the developer considerably. Use floating lid in replenisher tank to avoid air oxidation.

Concentrate per set:

Part A = 2 x 5,0 lt.,
Part B = 2 x 0,5 lt.,

MEDIPHOT F90

(liquid concentrate)

RP (Rapid Processing) ammonium thiosulfate based fixer with hardener, suitable for all types of Medical X-Ray Films, to be used in all types of roller transport processors.

Specifications:

High speed fixer within a wide temperature range.
Low replenishment rate fixer
Efficient hardening results in low water absorption which results in rapid drying. Keeps roller of processor clean, less crystallization on rollers.
Suitable for extended process-cycles and manual processing (no hardener to be added for manual processing). Available for all types of chemical mixers. Min. SO₂-emissions of ready mixed working solution.

Recommended Temperatures at various processing cycles:

Should not exceed the adjusted developer temperature.

Recommended Replenishment Rates:

350 – 400 ml/m² for medium/high volume film processing (150 films up/day)
450 ml/m² for low volume film processing (less than 100 films/day)
Silver content limit (approx.) 8 g/lit.

Mixing Temperature:

tempered water not more than 25°C

Specs for ready mixed, fresh working solution:

pH: 4.45 at 20°C (68°F)
Specific Gravity: 1.091 at 20°C (68°F)

NOTE: For cleaning of processor tanks and racks use MEDIPHOT Cleaning Chemistry and MEDIPHOT Neutraliser.

Concentrate per set:

Part A = 2 x 4,5 lt.,
Part B = 2 x 0,5 lt. (hardener)




set of chemistry for	type of chemistry	for ready to use solution	carton box size per set	weight kg per set per box	boxes per pallet	gross weight kg	volume m ³
2 x 20 = 40 Liters	Developer Concentrate E90	2 x 20 Liters	36 x 19 x 31 cm	15,0 kg	44	675	1,16
2 x 20 = 40 Liters	Fixer Concentrate F90	2 x 20 Liters	36 x 19 x 31 cm	14,0 kg	44	630	1,16
Bottle 0,5 Liter	Starter for Developer E90 S	20 ml per Liter Developer	For 6 x 0,5lt bottles: 23 x 16 x 18 cm	3,7 kg	-	-	-

Storage:


Shelf life 24 months when bottles are kept unopened, at ambient room temperature.

Mixing and Processing Recommendations:

see directions for use on labels

COLENTA Labortechnik
GmbH & Co. KG
Neunkirchner Strasse 117
A-2700 Wiener Neustadt
Austria
Tel: +43/2622/28 311-0
Fax: +43/2622/28 311-7
e-mail: office@colenta.at

More info regarding COLENTA Medical Product Line
see <http://www.colenta.at>

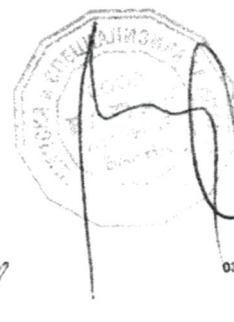

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписанит: Пламен Антонов Калайджиев, в качеството ми на: Управител (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ: "ЕШПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ - КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**, предлагам следните цени за изпълнение предмета на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя и техническото ни предложение,

За обособена позиция №7 Химикали за авт. обработка за рентгенови филми

№ на ОП	Наименование и пълно описание на медицинското изделие	Единица мярка	Планирано количество	Производител	Цена за единица мярка в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС (единица мярка x планирано количество)
7	Химикали за автоматична обработка за рентгенови филми					



Проявител Medirhot E90 Опаковка от 2 туби по 5 литра - концентрат Бързодействащ RP (Kapid Reosessing) проявител на основата на хидрохинон / фенидон, подходящ за всички видове рентгенови филми, за използване във всички ролкови проявителни машини. Ниска температура на проявяване Ниска консумация Повторяемост на резултатите с минимално замъгляване. Минимално окисляване. Барабанът на проявителната машина остава чист. Подходящ за продължителни програми и ръчно проявяване. Настройка на яркостта чрез промяна на температурата. Наличен за всички видове химически миксери. Препоръчителна температура при определено време за проявяване 37°C-39°C при 60 секунди 34°C-36°C при 90 секунди 33°C-35°C при 120 секунди 31°C-34°C при 150 секунди Препоръчителна скорост на подмяна: 300 мл/м² за среден/голям обем на проявяване (150 филма дневно) 400 мл/м² за нисък обем на проявяване 100 (филма дневно)		
7.1	брой	60

Colenta
Labortechnik
GmbH & Co,
Австрия


39.42	2365.2
-------	--------

[Handwritten signature]

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Фиксаж Mediphot F90	Опаковка от				
2 туби по 5 литра - концентрат Бързодействащ RP (Rapid Processing) фиксаж на основата на амониев трисулфат, подходящ за всички видове рентгенови филми, за използване във всички ролкови проявителни машини. Високоскоростен фиксаж с широк температурен обхват. Ниска консумация. Ефективно втвърдяване с ниска абзорбция на вода, което спомогат за бързо изсушаване. Остава барабана чист с по-малко отлагания. Подходящ за машинно и ръчно проявяване (в случай на ръчно проявяване не се добавя втвърдител). За всички видове за смесители. Минимални емисии на SO₂ на готовия работен разтвор. Препоръчителна температура при определено време за проявяване Температурата не трябва да превишава избраната температура на проявителя. Препоръчителна скорост на подмяна 350-400 мл/м² за среден/голям обем на проявяване (150 филма дневно) 450 мл/м² за нисък обем на проявяване 100 (филма дневно) Концентрация на сребро 8 г/л (прибл) Температура на смесване Не повече от 25 ° C	брой	60	Colenta Labor Technik GmbH & Co, Австрия	23.59	1415.4

7.2

Дата: 30.05.2018 г

Участник:

"ЕЛПАК - ДИЗИНГ" ЕООД

Управител:


инж. Пламен Калайджиев

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният: Пламен Антонов Калайджиев, в качеството ми на: Управител (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ: "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ - КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, предлагам следните цени за изпълнение предмета на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя и техническото ни предложение,**

За обособена позиция №6 Рентгенови филми

№ на ОП	Наименование и пълно описание на медицинското изделие	Единица мярка	Планирано количество	Производител	Цена за единица мярка в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС (единица мярка x планирано количество)
6	Рентгенови филми					



6.1	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 13/18 x 100 бр в кутия За употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящи за фолии с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрити емулсии – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	кутия	8	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	17.7	141.6
6.2	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 18/24 x 100 бр в кутия За употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящи за фолии с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрити емулсии – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	кутия	60	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	32.7	1962

Handwritten signature


Handwritten number 8

Handwritten signature


Handwritten signature



6.3	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 24/30 x 100 бр в кутия употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолия с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	кутия	60	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	54.53	3271.8
6.4	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 30/40 x 100 бр в кутия употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящ за фолия с редкоземни материали като MEDIPHOT KO100 - KO800. Двойно покрит емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	кутия	40	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	90.83	3633.2



6.5	Medirhot X-O/RP Зеленочувствителни филми 35/35 x 100 бр в кутии За употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящи за фолии с редкоземни материали като MEDIRHOT KO100 - KO800. Двойно покрити емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	кутии	75	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	95.93	7194.75
6.6	Medirhot X-O/RP Зеленочувствителни филми 20/40 x 100 бр в кутии За употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящи за фолии с редкоземни материали като MEDIRHOT KO100 - KO800. Двойно покрити емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	кутии	35	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	60.53	2118.55



6.7	Mediphot X-O/RP Зеленочувствителни филми 35/43 x 100 бр в кутия За употреба с излъчващ екран със зелена светлина. Подходящи за фолии с редкоземни материали като МЕДИРНОТ КО100 - КО800. Двойно покрита емулсия – отлична дефиниция с висок контраст и минимално замъгляване. Подходящи за серийни експозиции и системи с бърза смяна на филмите. С електростатичен защитен слой. За 90 сек автоматично проявяване, удължено проявяване и системи за ръчно проявяване. Основа от син полиестер с дебелина от 0.18 мм.	кутия	50	Colenta Labortechnik GmbH & Co, Австрия	116.4	5820
-----	---	-------	----	---	-------	------


Дата:30.05.2018 г

Участник:

"ЕШПАК - ЛЕЗИН" ЕООД

Управител:

инж. Пламен Калайджиев



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ” АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

№ на ОП	Наименование	Единица мярка	Планирано количество в единица мярка	Обща стойност в лева без ДДС
ОП 1	Обособена позиция №1 Системи			
1.1	Инфузионни системи	бр.	100 000	21 000
1.2	Трансфузионни системи	бр.	8 500	2 720
1.3	Удължител система за перузия	бр.	9 600	2 500
ОП 2	Обособена позиция №2 Кислородни маски			
2.1	Система за назално подаване на кислород	бр.	150	100
2.2	Кислородна маска с удължител	бр.	2 000	1 700
2.3	Небулайзер за инхалатор с маска	бр.	500	1 000
ОП 3	Обособена позиция №3 ЦВК			
3.1	Централен венозен катетър - v.subclavia 14G, 1.4x2.1 48 см 81 мл/мин	бр.	600	9 600
3.2	Централен венозен катетър - v.jgolaris	бр.	100	1 600
3.3	ЦВК - еднолуменен по Селдингер 7FR - 20 см	бр.	50	1 000
ОП 4	Обособена позиция №4 Гел			
4.1	Гел за ултразвук - 260 гр.	бр.	600	800
4.2	Гел за ултразвук - 5 кг	кг	200	500
ОП 5	Обособена позиция №5 Ръкавици			
5.1	Ръкавици нестерилни еднократни найлон - 100 броя в опаковка	опаковка	4 000	3 700
5.2	Ръкавици - латекс х 100 бр. в кутия	кутия	9 000	35 300
5.3	Ръкавици - стерилни	чифт	60 000	19 800
5.4	Ръкавици - стерилни хироалергични без пудра	чифт	20 000	9 400
ОП 6	Обособена позиция №6 Рентгенови филми			
6.1	Филми 13/18 х 100 бр. в кутия	кутии	8	320
6.2	Филми 18/24 х 100 бр. в кутия	кутии	60	3 200
6.3	Филми 24/30 х 100 бр. в кутия	кутии	60	5 300
6.4	Филми 30/40 х 100 бр. в кутия	кутии	40	6 000
6.5	Филми 35/35 х 100 бр. в кутия	кутии	75	11 800
6.6	Филми 20/40 х 100 бр. в кутия	кутии	35	3 500
6.7	Филми 35/43 х 100 бр. в кутия	кутии	50	9 500
ОП 7	Обособена позиция №7 Химикали за авт. обработка за рентгенови филми			
7.1	Проявител - 5 литра туба	бр.	60	5 200
7.2	Фиксаж - 5 литра туба	бр.	60	4 300